

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu *mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế dự án mua sắm thường xuyên thuộc dự toán mua sắm hàng hóa, vật tư y tế, dịch vụ* với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy – 201B Nguyễn Chí Thanh, P12, Quận 5
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: KS. Nguyễn Đắc Tâm

Số điện thoại: 0908795780

Địa chỉ email: baogiatbycr@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá, một trong hai cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành Chính - Bệnh viện Chợ Rẫy (Báo giá trang thiết bị y tế) - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

Nhận qua email : baogiatbycr@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 21. tháng 8... năm 2023 đến trước 17h ngày 05..tháng 9..năm 2023

**Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05... tháng 09.. năm 2023.



## II.Nội dung yêu cầu báo giá :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
	<b>Yêu cầu chung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo linh kiện thay thế mới 100%, đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng của nhà sản xuất.</li> <li>- Thời gian bảo hành ≥ 6 tháng.</li> </ul>		
1	Bóng đèn Xenon 300W dùng cho nguồn sáng Xenon nova 300. Hãng : Karl Storz / Đức.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất 300W.</li> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	01	Cái
2	Board mạch nguồn cho Monitor bệnh nhân model: MX430. Hãng: Philips / Đức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	01	Cái
3	Bộ vỏ máy dùng cho monitor bệnh nhân model BSM-5135K. Hãng: Nihon Kohden / Nhật.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	01	Bộ
4	Màn hình cảm ứng dùng cho monitor bệnh nhân model BSM-5135K. Hãng: Nihon Kohden / Nhật.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	01	Cái
5	Bơm huyết áp dùng cho monitor bệnh nhân model BSM-5135K. Hãng : Nihon Kohden / Nhật.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	02	Cái
6	Bộ cảm biến nhiệt độ cho máy điều nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu</li> </ul>	01	Bộ

	của hệ thống máy tim phổi nhân tạo. Hãng Terumo / Mỹ,	chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.		
7	Pin dự phòng 12V 24AH dùng cho hệ thống máy tim phổi nhân tạo HL20. Hãng Maquet / Sweden,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	02	Cái
8	Dây belt bơm đơn dùng cho hệ thống máy tim phổi nhân tạo HL20. Hãng Maquet / Sweden,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư phải tương thích đồng bộ, chính hãng.</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	02	Dây
9	Cảm biến lưu lượng cho máy gây mê GE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến lưu lượng thay thế phải tương thích đồng bộ với máy gây mê model: Aespire 7100, hãng: GE.</li> <li>- Đảm bảo máy gây mê hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay thế.</li> </ul>	02	Cái
10	Bình hấp thụ vôi soda dùng nhiều lần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bình vôi soda thay thế phải tương thích đồng bộ với máy gây mê model: Aespire 7100, hãng: GE.</li> <li>- Đảm bảo máy gây mê hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay thế.</li> </ul>	01	Cái
11	Máy phun khí dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau</li> <li>- Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt độ hoạt động tối đa đến <math>\geq 40^{\circ}\text{C}</math></li> <li>+ Độ ẩm hoạt động tối đa đến <math>\geq 75\%</math></li> </ul> </li> <li>- Yêu cầu cấu hình: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Máy chính: 01 cái</li> <li>+ Bầu phun khí dung: 01 cái</li> <li>+ Dây dẫn khí: 01 cái</li> <li>+ Mặt nạ thở người lớn: 01 cái</li> <li>+ Mặt nạ thở trẻ em: 01 cái</li> <li>+ Bộ lọc</li> <li>+ Miếng ngáng miệng: 01 cái</li> </ul> </li> <li>- Bảo hành <math>\geq 1</math> năm</li> </ul>	06	Máy




12	Bóng đèn cho đèn mổ Berchtold	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp 22,8V</li> <li>- Công suất 150W</li> <li>- Bóng đèn phải tương thích đồng bộ với đèn mổ hãng Berchtold</li> <li>- Đảm bảo đèn mổ hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay thế</li> </ul>	40	Cái
13	Proportional valve sử dụng cho máy giúp thở: - Model: Elisa 300 - Hãng: Lowenstein Medical	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật tư thay thế phải tương thích đồng bộ với máy giúp thở hãng Lowenstein Medical</li> <li>- Đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất sửa chữa thay thế linh kiện.</li> </ul>	01	Cái

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại “Bảng mô tả” đính kèm
2. Thời gian giao hàng dự kiến: (Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu)
3. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
  - Về tạm ứng: Sau khi nhà thầu đã hoàn tất việc ký hợp đồng và thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, sẽ được tạm ứng tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng.
  - Về thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thanh toán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ, hàng hoá đã được giao đủ cho Bệnh viện. Thể hiện bằng biên bản bàn giao và nghiệm thu. Lưu ý các chứng từ thanh toán có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của quản lý tài chính của Nhà nước.
4. Các thông tin khác (nếu có).
5. Các nhà cung cấp báo giá theo Phụ lục mẫu yêu cầu báo giá và báo giá theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT .

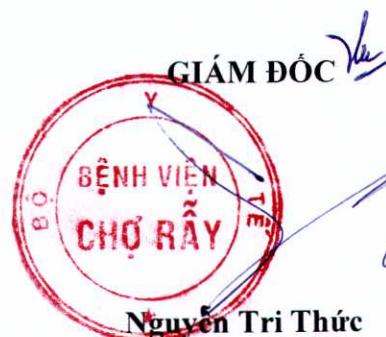

Nguyễn Tri Thức