

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 117 /BVCR-TTBYT  
Về việc gia hạn thời hạn tiếp  
nhận báo giá của yêu cầu báo  
giá số 87/BVCR-TTBYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**Kính gửi: Nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Ngày 02/02/2024, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ban hành công văn số 87/BVCR-TTBYT về việc yêu cầu báo giá gói thầu cung cấp ““Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model sterrad 100NX, sn: 1042170076” với thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 05/02/2024 đến trước 17h00 ngày 23/02/2024.

Đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy chưa tiếp nhận được đủ báo giá theo quy định. Vì vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy xin thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá của công văn yêu cầu báo giá số 26/BVCR-TTBYT: Từ sau 17h00 ngày 23/02/2024 đến trước 17h00 ngày 08/03/2024. Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.


*Đính kèm: Công văn yêu cầu báo giá số 87/BVCR-TTBYT ngày 02/02/2024.*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tri Thức

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 87 /BVCR-TTBYT  
V/v: yêu cầu báo giá gói thầu  
cung cấp dịch vụ bảo trì bảo  
dưỡng bao gồm thay thế linh  
kiện/phụ kiện (lần 2)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model sterrad 100NX, sn: 1042170076” năm 2024 của Bệnh Viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line: 1213.  
Email: [baogia.bvcr@gmail.com](mailto:baogia.bvcr@gmail.com)


3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Địa chỉ email: [baogia.bvcr@gmail.com](mailto:baogia.bvcr@gmail.com) nhận file mềm và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá :

- Từ 08h00 ngày 05 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 02 năm 2024.

**Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**



lu

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá :

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2024.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ <sup>(*)</sup>	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model: sterrad 100NX, sn: 1042170076”  (đính kèm “phụ lục 01: thông tin về thiết bị và hoạt động của thiết bị”)	Theo phụ lục 02	01	gói	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy	Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng


### LƯU Ý:

- Các đơn vị cung cấp báo giá theo đơn giá từng danh mục dịch vụ.
- Hình thức xét chọn: loại hợp đồng trọn gói bao gồm tất cả các danh mục dịch vụ đáp ứng.
- Hồ sơ báo giá thực hiện theo “Biểu mẫu 01” và hoàn thiện nội dung đáp ứng theo đúng cấu trúc “Biểu mẫu 02” trong hồ sơ yêu cầu báo giá. Không được thay đổi định dạng hoặc bỏ trống, nếu có điều chỉnh định dạng của biểu mẫu này có thể bị xem là không hợp lệ đối với những nội dung không đúng định dạng của biểu mẫu. Việc đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của bảng báo giá chỉ dựa vào “Biểu mẫu 01 và 02”.
- Trong cột khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp vui lòng ghi rõ “có hoặc không” ở từng mục. Nếu có hạng mục nào không đáp ứng vui lòng ghi rõ lý do và đề xuất ở “cột ghi chú” để Bệnh viện xem xét.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT

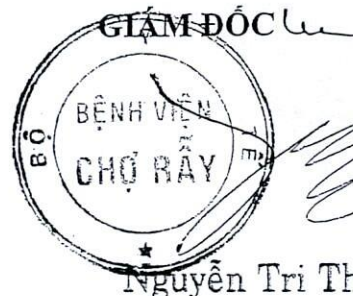

Nguyễn Tri Thức

## PHỤ LỤC 01

## THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ VÀ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ

## I. Thông tin thiết bị/ hệ thống:

- Tên thiết bị: MÁY HẤP TIẾT KHUẨN NHIỆT ĐỘ THẤP
- Số lượng: 01
- Nhà sản xuất: JOHNSON & JOHNSON
- Model: STERRAD 100 NX
- Serial Number: 1042170076
- Khoa sử dụng: Kiểm soát nhiễm khuẩn (khu D)

## II. Thông tin về hoạt động của hệ thống/ thiết bị:

- Ngày đưa vào sử dụng: 01/6/2018
- Thiết bị đang:  Hoạt động  Không hoạt động
- Các lỗi hiện tại trên máy (nếu có):
  - o Notice Of Planned Maintenance 1 Past Due. Maintenance was due by: Nov 2022
  - o UV Path is blocked.
  - o H2O2 Adjustment in progress
- Lịch sử hệ thống/ thiết bị (trong vòng ít nhất 12 tháng):

Mã	Nội dung lỗi	Thời gian báo hư hỏng	Thời gian khắc phục	Cách khắc phục/ Thay thế
1	PM 1 Warning	11/09/2020	11/9/2020	Kiểm tra thiết bị Thay thế bộ PM 1 Chạy chu trình – OK
2	Lỗi Chamber pump	7/4/2022	7/4/2022	Thay thế Delivery valve
3	PM 2 Warning	18/5/2022	18/5/2022	Kiểm tra thiết bị Thay thế bộ PM 2 Chạy chu trình – OK
4	Upgrade software	18/5/2022	18/5/2022	Kiểm tra thiết bị Nâng cấp phần mềm Chạy chu trình – OK
5	Notice of PM 1 Past Due	30/11/2022		Đến hạn bảo trì nhưng chưa thay Kit
6	H2O2 Adjustment progress	2/2/2023		Cần mua gói bảo trì để thay thế/khắc phục lỗi
7	UV Path is blocked	2/2/2023		Cần mua gói bảo trì để thay thế/khắc phục lỗi

## PHỤ LỤC 02

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model sterrad 100NX, sn: 1042170076”

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model: sterrad 100NX, sn: 1042170076”	<p><b>a. Phạm vi thực hiện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính và các thiết bị, phụ kiện chính Hãng theo kèm</li> </ul> <p><b>b. Yêu cầu dịch vụ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng phòng ngừa: Thực hiện bảo định kỳ <math>\geq 2</math> lần/năm theo đúng quy trình nhà sản xuất. Nhà thầu đính kèm hướng dẫn và quy trình bảo dưỡng có đóng dấu xác nhận</li> <li>- Thời gian thực hiện dịch vụ: Tất cả các ngày trong tuần</li> <li>- Hỗ trợ online (24h/24h) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì</li> <li>- Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt máy để kiểm tra và sửa chữa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian phản hồi: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi.</li> <li>+ Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra nếu cần thiết: Trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố.</li> </ul> </li> <li>- Cam kết thay thế tất cả các linh kiện/ phụ kiện cho toàn bộ hệ thống không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng. Tất cả linh kiện, phụ kiện sau khi được thay thế mới thì nhà thầu có trách nhiệm bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện, phụ kiện.</li> <li>- Cam kết tổng thời gian dừng máy trong suốt thời gian bảo trì <math>\leq 18</math> ngày/ năm (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết):               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ ngày dừng máy số 19, mỗi ngày dừng máy sẽ được quy thành 2 ngày bảo trì cộng thêm</li> <li>+ Cách tính số ngày dừng máy: Nếu máy dừng trong khoảng thời gian:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 giờ - 4 giờ/ngày làm việc thì tính là 1/2 ngày</li> <li>• &gt;4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày</li> <li>• Đối với thứ 7, CN, lễ tết &gt;8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Đảm bảo hệ thống sau bảo trì hoạt động an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu chuyên môn</li> <li>- Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Theo dõi điều kiện hoạt động thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm, ...) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng khuyến nghị</li><li>- Nhân viên thực hiện bảo trì, kiểm tra phải có chứng chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật do Nhà sản xuất cấp</li><li>- Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng</li><li>- Thực hiện công việc theo quy trình tối thiểu sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của hệ thống và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên</li><li>+ Đánh giá tình trạng hệ thống sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của 2 bên</li></ul></li></ul>
--	--

## BIỂU MẪU 01

BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model: sterrad 100NX, sn: 1042170076”	Theo biểu mẫu 02	01	gói		
<b>Tổng cộng:</b>						

(Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác của gói thầu)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

lee



## BIỂU MẪU 02

**Yêu cầu dịch vụ:** Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model: sterrad 100NX, sn: 1042170076”

STT	Danh mục dịch vụ	Nội dung yêu cầu của Bệnh viện	Khả năng đáp ứng của Đơn vị cung cấp (ghi rõ có hoặc không)	Ghi chú
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho “Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Johnson & Johnson, model: sterrad 100NX, sn: 1042170076	<p><b>a. Phạm vi thực hiện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính và các thiết bị, phụ kiện chính Hãng theo kèm</li> </ul> <p><b>b. Yêu cầu dịch vụ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng phòng ngừa: Thực hiện bảo định kỳ <math>\geq 2</math> lần/ năm theo đúng quy trình nhà sản xuất. Nhà thầu đính kèm hướng dẫn và quy trình bảo dưỡng có đóng dấu xác nhận</li> <li>- Thời gian thực hiện dịch vụ: Tất cả các ngày trong tuần</li> <li>- Hỗ trợ online (24h/24h) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì</li> <li>- Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt máy để kiểm tra và sửa chữa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian phản hồi: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi.</li> <li>+ Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra nếu cần thiết: Trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố.</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>- Cam kết thay thế tất cả các linh kiện/ phụ kiện cho toàn bộ hệ thống không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng. Tất cả linh kiện, phụ kiện sau khi được thay thế mới thì nhà thầu có trách nhiệm bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện, phụ kiện.</p>	
	<p>- Cam kết tổng thời gian dừng máy trong suốt thời gian bảo trì <math>\leq 18</math> ngày/ năm (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ ngày dừng máy số 19, mỗi ngày dừng máy sẽ được quy thành 2 ngày bảo trì cộng thêm</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cách tính số ngày dừng máy: Nếu máy dừng trong khoảng thời gian:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o 2 giờ - 4 giờ/ngày làm việc thì tính là 1/2 ngày</li> <li>o &gt;4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày</li> <li>o Đối với thứ 7, CN, lễ tết &gt;8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đảm bảo hệ thống sau bảo trì hoạt động an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu chuyên môn</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo dõi điều kiện hoạt động thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm, ...) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng khuyến nghị</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân viên thực hiện bảo trì, kiểm tra phải có chứng chỉ thực hiện dịch vụ kỹ thuật do Nhà sản xuất cấp</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng</li> </ul>	

